


Urina – Analisi chimiche: urina spontanea

Provetta per urina spontanea, senza conservante (52) o con acido cloridrico (53)

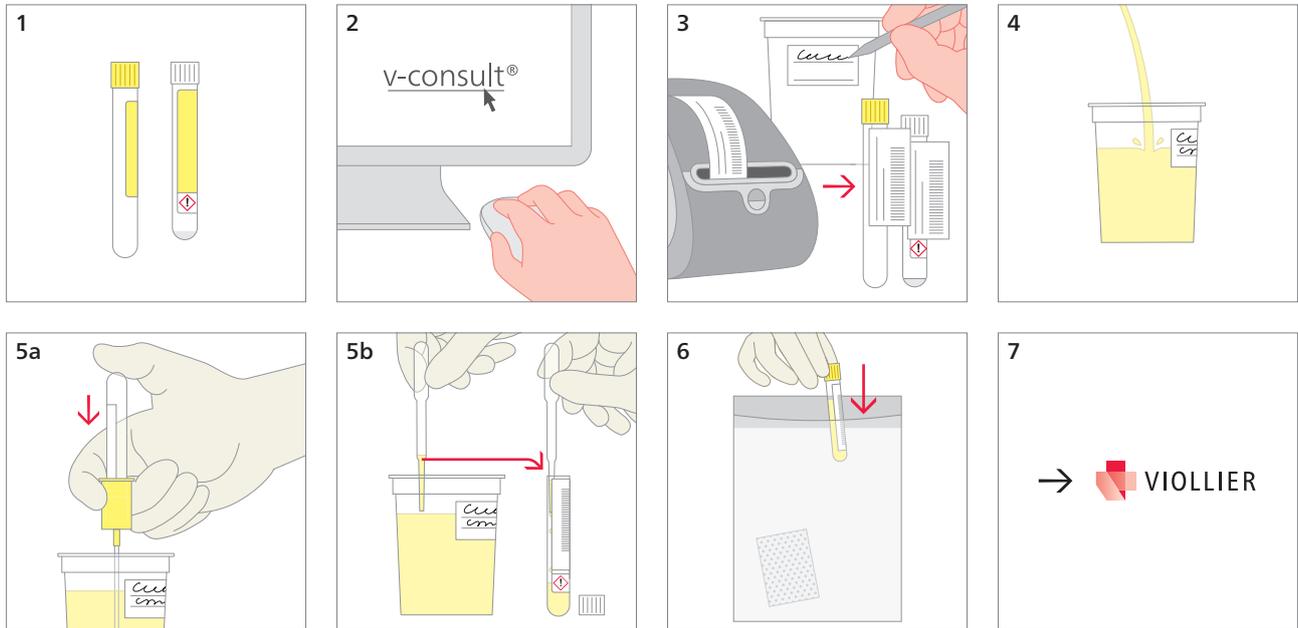

- 1** Scelta del corretto contenitore per le urine senza o con conservante
- 5a** Riempire una provetta per urina spontanea senza conservante (52)
- 5b** Riempire una provetta urina spontanea con acido cloridrico (53)

Il volume di urina e il contenitore per urina appropriato secondo v-consult